



D (number of needle strips)

Detail X
M 5:1

A = ϕ	mm	B $\geq \phi$ 80 mm	D max.24
B = ϕ	"	B $\geq \phi$ 100 mm	D max.30
C = ϕ	"	B $\geq \phi$ 120 mm	D max.36
D =		B $\geq \phi$ 140 mm	D max.42
L =	mm	B $\geq \phi$ 160 mm	D max.48

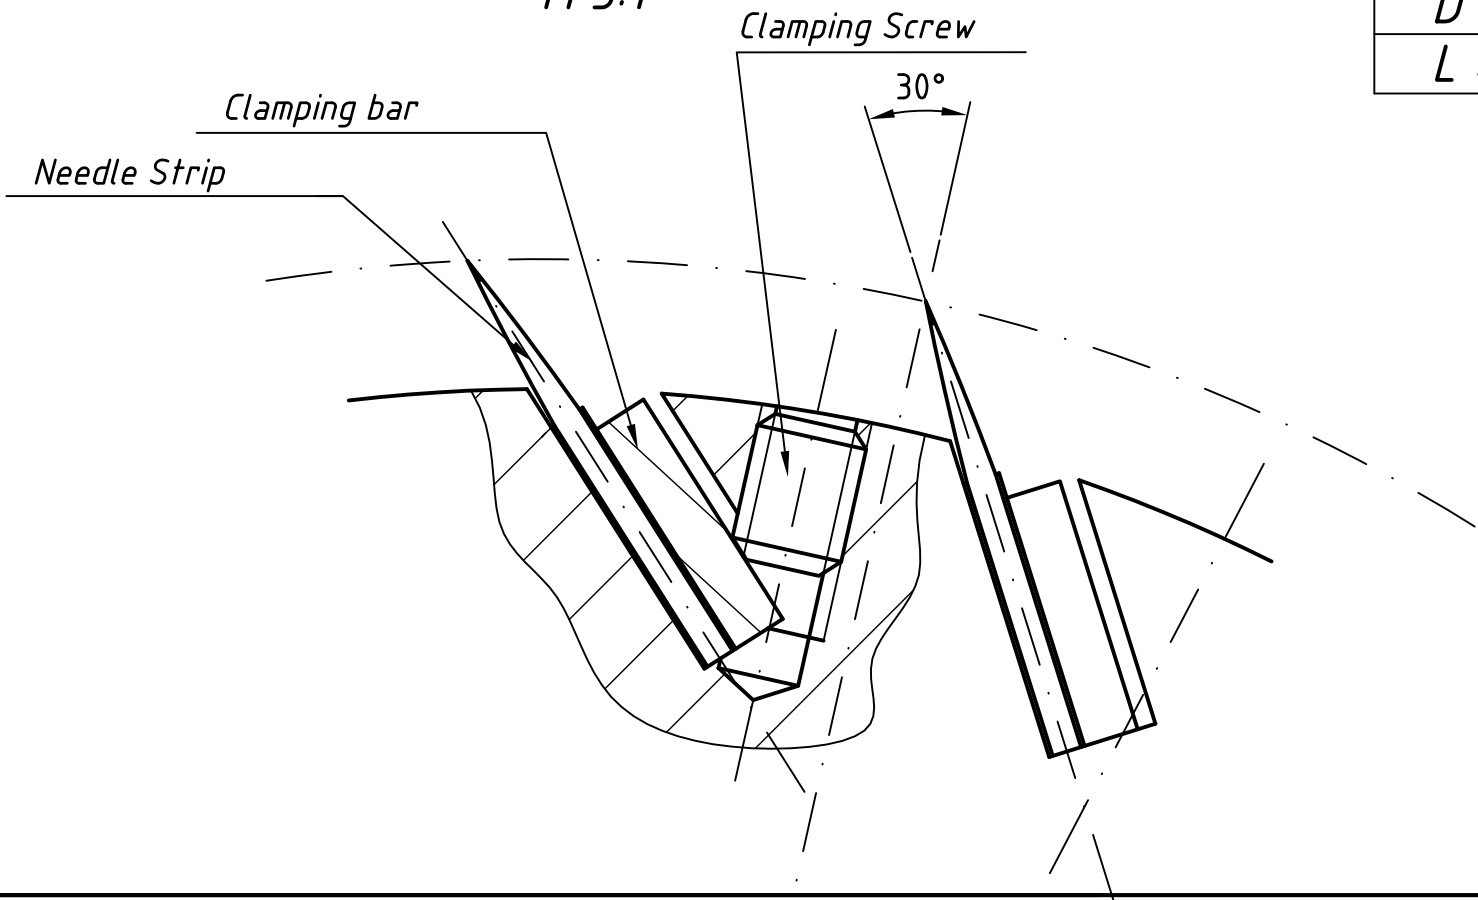

Stückzahl	Benennung und Bemerkung	Teil	Zch.Nr.:		
<p>Änderungen Diese Zeichnung darf nur im CAD-System geändert werden, alle anderen Einträge sind ungültig!</p>					
Gezeichnet	Datum	Name	 <p>STAEDTLER & UHL 91126 Schwabach</p>		
Geprüft					
Normgepr.					
Maßstab	Data Sheet			5113.3	
1:1	fibrillating roller			Ersatz für	
5:1				Ersetzt durch	